



Cas 4 - LA QUALITAT DE L'AIGUA: INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES ENTRE ISRAEL I CATALUNYA

LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

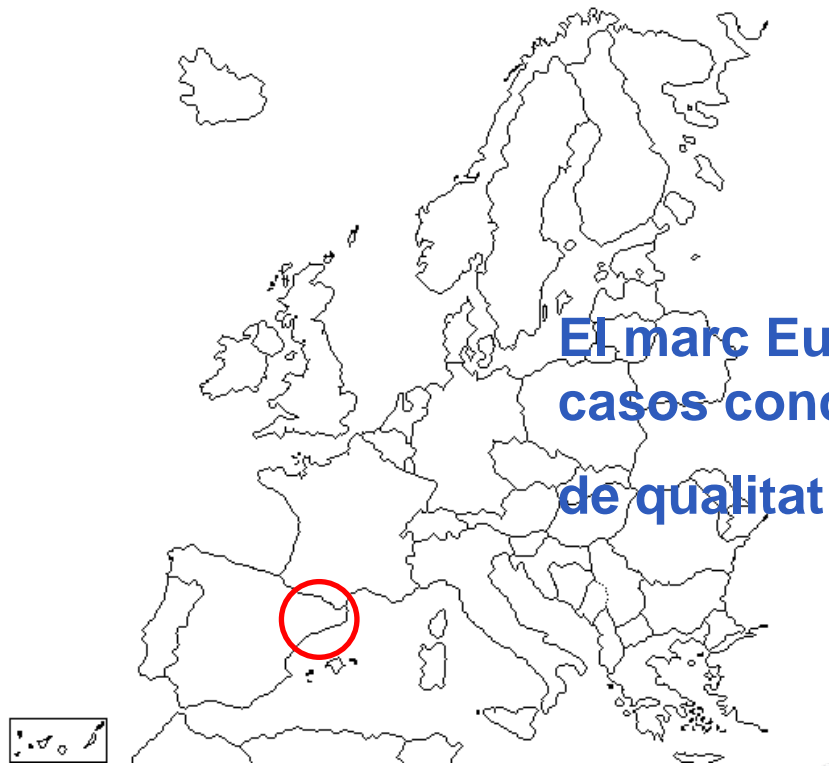


El marc Europeu, es qui en la majoria de casos condiciona els requeriments mínims de qualitat

LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

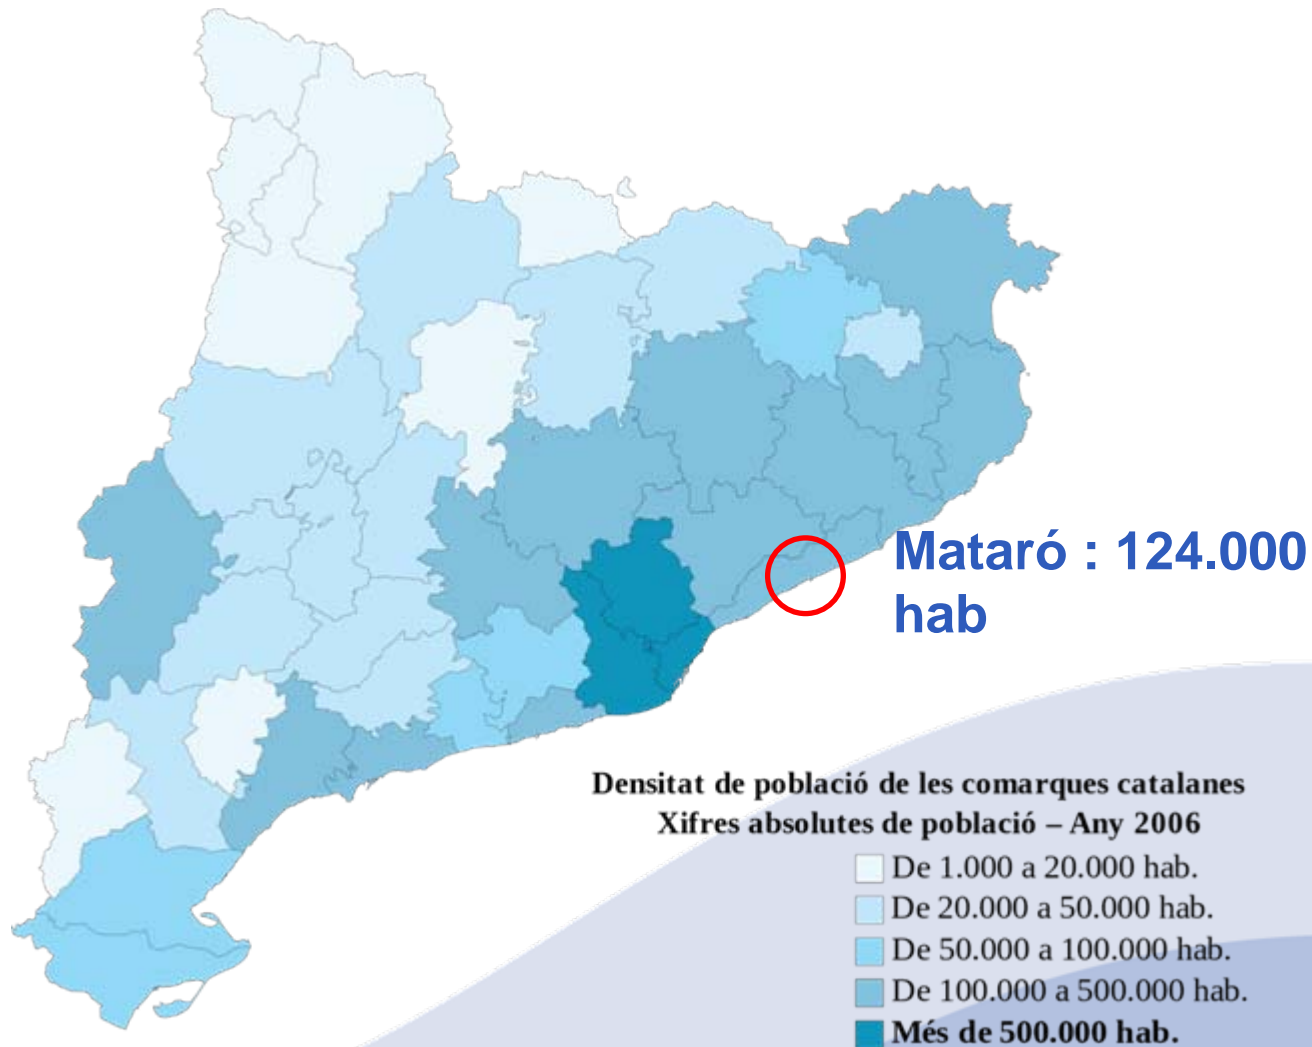

LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

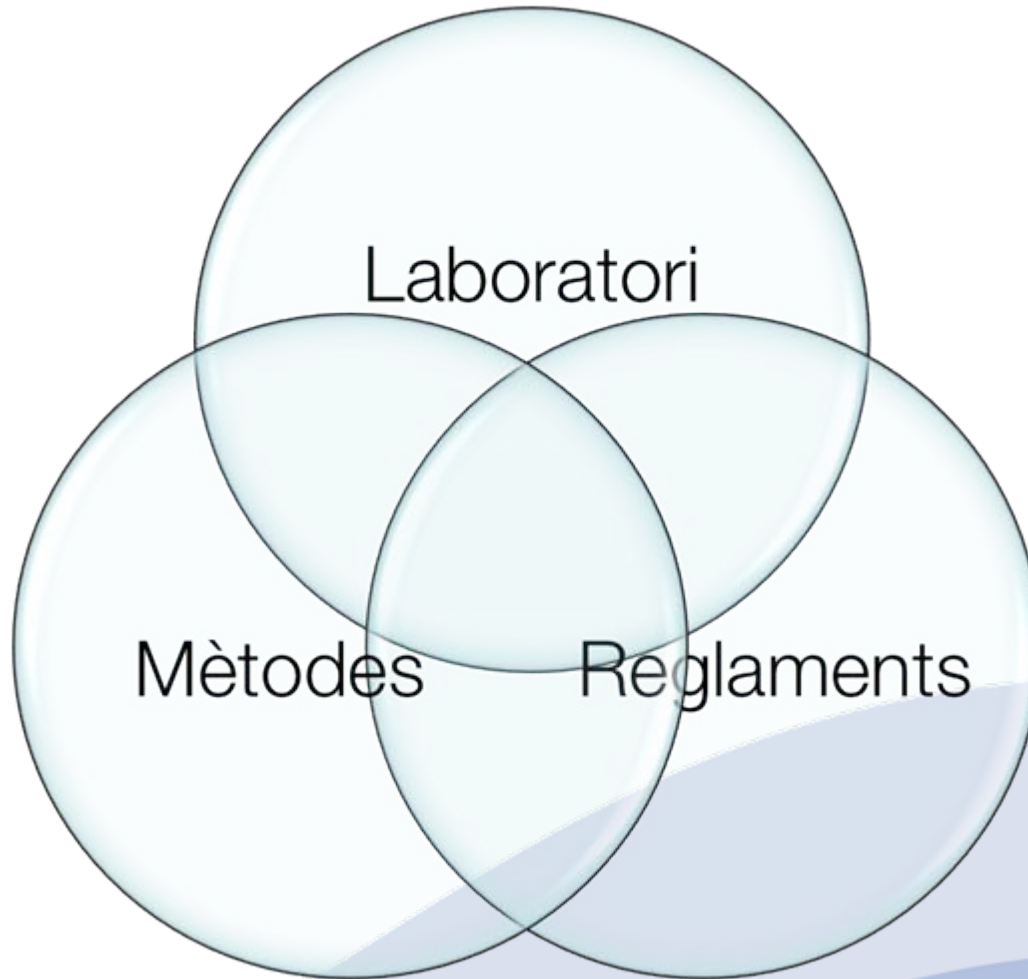


LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

Transposicions de directives EU

-Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.


-Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

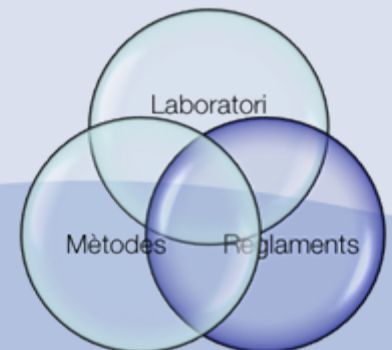

LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

Reglamentacions Estatals

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
- Real Decreto 742/2013, de 7 de diciembre, por el que se por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

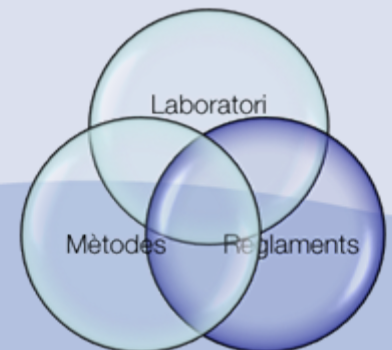


LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

Reglamentacions Catalanes

-DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.


-DECRET 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic (*)

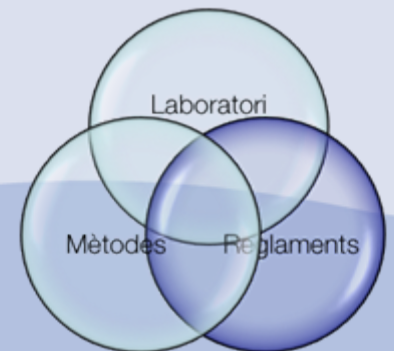

LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

Reglamentacions Locals

-EDICTE BOP 77/2004, de 30 de Març, Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals de la comarca del Maresme

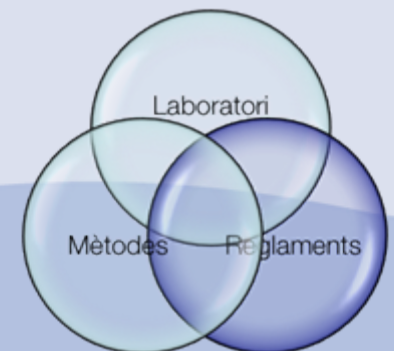


LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

Laboratoris (*)

-Certificació: ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.


-Acreditació: ISO 17025. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

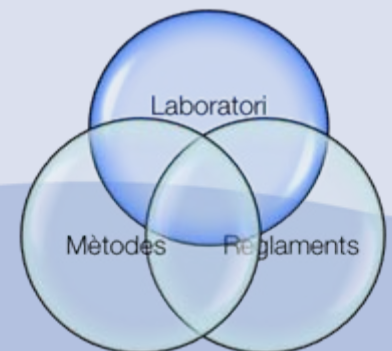


LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

Mètodes d'assaig

17025, 5.4.2 El laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo o de calibración, incluidos los de muestreo, que satisfagan las necesidades del cliente y que sean apropiados para los ensayos o las calibraciones que realiza. Se deben utilizar preferentemente los métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales.

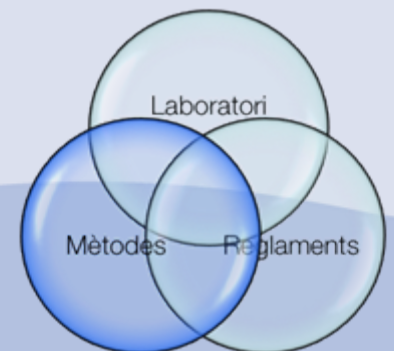

LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

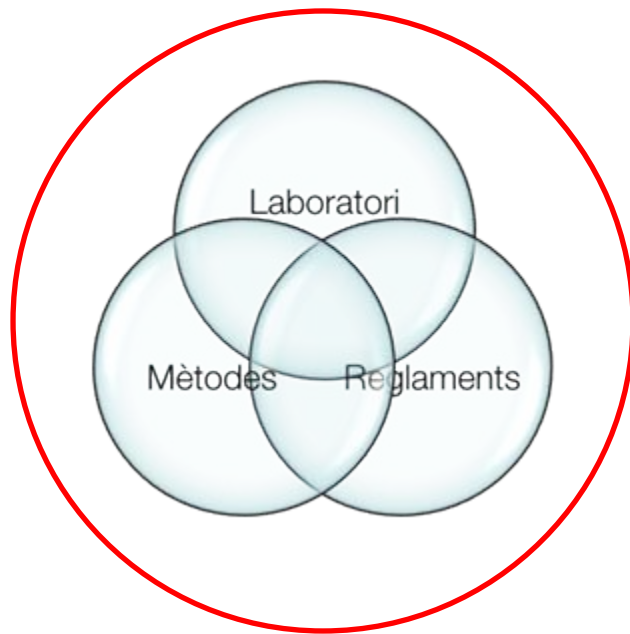

Control de qualitat
vs
Gestió de qualitat.

LA QUALITAT DE L'AIGUA : Catalunya

TIPUS	MOSTRES	Par.	TIPUS	MOSTRES	Par.
AIGÜES DE MATARÓ			AJUNTAMENT DE MATARÓ		
Aigua xarxa: Cia. AMSA	9.068	56.308	Sanitat		
Aigua pou: Cia. AMSA	1.498	14.899	Aigua de piscina: Servei de Salut Pública	280	2.887
Aigua residual xarxa clavegueram	293	752	Aigua control Servei de Salut Pública	196	992
Fonts ornamentals: Cia. AMSA	783	3.803	Control Ambiental	26	78
Fonts públiques: Cia. AMSA	2.108	6.317		<hr/>	<hr/>
Aigua xarxa de reg	26	128		502	3.957
Totals Aigües Mataró	13.776	82.207	Medi Ambient		
			Aigua de mar: S. de MA i S. Emissari submarí	56	112
			Aigua de mar: Servei de MA i Sostenibilitat	112	672
			Aigua pou: Servei de MA i Sostenibilitat	13	156
				<hr/>	<hr/>
				181	940
			Parcs i Jardins: Legionella Xarxa reg	79	474
Mostres EDAR Mataró (*)	4.830	11.007	Planificació: Legionel·la	487	2.844
			Totals Ajuntament	1.249	8.215

תודה
Dankie Gracias
Спасибо شكراً
Merci Takk
Köszönjük Terima kasih
Grazie Dziękujemy Děkojame
Ďakujeme Vielen Dank Paldies
Kiitos Täname teid 谢谢
Thank You Tak
感謝您 Obrigado Teşekkür Ederiz
Σας Ευχαριστούμ 감사합니다
ขอบคุณ
Bedankt Děkujeme vám
ありがとうございます
Tack